

入札公告

下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6及び新潟市契約規則（昭和59年新潟市規則第24号）第8条の規定に基づき公告します。

令和8年 1月 6日

新潟市病院事業管理者 大谷 哲也

1 入札に付する事項

(1) 件名	スチームコンベクションオーブン
(2) 品質・規格・数量など	仕様書のとおり
(3) 契約の条項を示す場所	新潟市民病院 事務局 管理課
(4) 入札日時・場所	令和8年 1月30日 10時 新潟市民病院 201会議室
(5) 履行期限・履行場所	令和8年 3月24日 新潟市民病院
(6) 入札方式	契約方式は、総価での入札とします。
(7) 入札保証金	新潟市民病院契約規程の規定によりその例によることとされる新潟市契約規則第10条第2号に該当する場合免除
(8) 入札を無効とする場合	新潟市民病院契約規程の規定によりその例によることとされる新潟市契約規則第17条第1項の規定に該当するときは無効とし、入札者が談合その他不正な行為をしたと認められる場合はその入札の全部を無効とします。
(9) 入札を中止とする場合	新潟市民病院契約規程の規定によりその例によることとされる新潟市契約規則第19条の規定に該当する場合のほか、対象の入札参加資格者が少数で、競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがあります。
(10) 談合情報等により公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、前項の規定によるほ	談合情報等により、公正な入札が行われないおそれがあると認められるときは、前項の規定によるほ

きの措置	か、抽選により入札者を決定するなどの場合があります。
(11) 契約保証金	新潟市民病院契約規程の規定によりその例によることとされる新潟市契約規則第33条及び第34条の規定によります。
(12) 予定価格	公表しません。
(13) 最低制限価格	設けません。
(14) 契約締結について議会の議決を要するための仮契約	無

2 入札参加資格の要件

- (1) 新潟市内に本店、支店又は営業所があり、かつ、当該本支店等が本市の競争入札参加資格者名簿「物品」に登載されている者。
- (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者
- (3) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置を受けていない者
- (4) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の別表第2の9の措置要件に該当しない者

3 入札の参加手続

一般競争入札に参加を希望する場合、次により申請してください。なお、入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。

- (1) 提出書類 一般競争入札参加申請書（別記様式第2号） 1部
なお、入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。
- (2) 提出先 新潟市民病院 事務局 管理課
〒950-1197 新潟市中央区鐘木463番地7
電話 025-281-5151（代表）
FAX 025-281-5187
E-mail kanri.ch@city.niigata.lg.jp
- (3) 提出方法 持参
- (4) 申請期限 令和8年 1月26日
- (5) 受付期間 入札公告の日から入札参加申請期限の日の午前9時～午後5時
(土・日・祝日を除く)

4 質疑書の提出について

質疑事項がある場合は、次により質疑書を提出してください。

- (1) 様式 別紙に準じて作成してください。
- (2) 提出期限 令和 8 年 1 月 15 日
- (3) 提出先 3 (2) と同じ
- (4) 提出方法 ファクシミリ又はメールとします。
- (5) 回答日 令和 8 年 1 月 19 日まで
- (6) 回答方法 個別にファクシミリ（またはメール）にて回答するほか、新潟市民病院ホームページに掲載します。
- (7) その他 電話での受付は一切行いません。
質疑書には、返信用ファクシミリ番号（またはメールアドレス）を記入してください。

5 同等品の照会

上記 1 記載の物品以外の同等の品質、機能を有する製品（同等品）の納入を希望する場合は、下記により必要な書類等を揃えて照会し、了承を得ること。

(1) 照会方法

別紙様式「同等品承認願」に、該当する品名及び同等品のメーカー名、銘柄等を記載するとともに、カタログの写し等を添付する他、参考銘柄と同等の品質、機能を有することを証する資料を添付すること。

- (2) 照会期間 令和 8 年 1 月 21 日 午後 3 時まで
- (3) 照会先 新潟市民病院 事務局 管理課 施設グループ
- (4) その他 電話での受付は一切しません。持参に限る。

（受付時間：土・日・祝日を除く、午前 9 時から午後 5 時まで）

6 入札時の注意事項

- (1) 入札参加申請後に入札を辞退する場合は、書面で届け出してください。
- (2) 入札時間に遅れた場合は、入札に参加できません。
- (3) 入札場所に入室できるのは、入札参加申請者毎に原則 1 名とします。
- (4) 代理人が入札する場合は、委任状を提出してください。
- (5) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額）をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請者は、消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。なお、入札金額の訂正は無効とします。
- (6) 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を一回行います。ただし、初度入札で無効とされた者、失格となった者及び最低制限価格を

設けたときであって最低制限価格未満の入札を行った者は、再度入札に参加できません。

- (7) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者が2者以上ある場合は、くじ引きで落札者を決定します。

7 落札者の決定

落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表します。

ただし、落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は、落札決定を取り消し、仮契約を締結していた場合は、本契約を締結しないものとします。

別紙

質 疑 書

年 月 日

住 所
商号又は名称
代表者氏名

(押印不要)

(担当者)

(ファクス (メールアドレス))

- 1 番 号 病第 2025057 号
2 件 名 スチームコンベクションオーブン

質 疑 事 項

別紙様式

同 等 品 承 認 願

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

(担当者)

(電話番号)

(F A X番号)

1 番 号 病第 2025057 号

2 品 名 スチームコンベクションオーブン

仕様書記載の品名	同等品承認希望品

別記様式第2号

一般競争入札参加申請書

年 月 日

(宛先) 新潟市病院事業管理者

申請者
郵便番号
所在地
商号又は名称
代表者氏名
担当者
(電話)
(ファクス(メールアドレス))

(押印不要)

下記入札の参加資格要件を満たしており、入札に参加したいので、新潟市物品等一般競争入札実施要綱第5条第1項の規定により申請します。

記

公告年月日	令和 年 月 日
番 号	病第 2025057 号
件 名	スチームコンベクションオーブン

別記様式第1号

入札書

令和 年 月 日

(宛先) 新潟市病院事業管理者

住 所

氏 名

印

受任者

印

新潟市民病院契約規程及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。

入札金額	百	千	円	
入札保証金	百	千	円	
履行期限	令和 年 月 日			
履行場所				
品名	品質・規格	数量	単価	金額
特約条項				
摘要				

委任状

令和 年 月 日

(宛先) 新潟市病院事業管理者

私は次の者をもって、下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。

委任者 住所

氏名 印

受任者 氏名 印

記

品名 スチームコンベクションオーブン

別記様式第3号
(物品・委託用)

入札辞退届

件名：スチームコンベクションオーブン

上記について、都合により入札を辞退します。

(宛先) 新潟市病院事業管理者

年月日

住所

商号又は名称

代表者氏名

印

仕 様 書

1. 入札対象物品名

(1) 入札対象物品・数量

- スチームコンベクションオーブン 1台
・ 給排水ガス電気接続工事含む
ラックインカート 1台

(2) オプション内容

- スチームコンベクションオーブン
・ 軟水器付属（給水接続管、軟水器固定板付）
・ 外部芯温センサー
・ 外部芯温収納BOX
・ アローライト
・ ブラストチラー対応ラックインカート（ラックカート板下つゆ受け無）
・ 電源防水ゴムキャップ引掛けタイプ（WF 8430）
ラックインカート
・ 上記スチームコンベクションオーブンオプション品と同じ仕様とする

(3) 保守体制

① 保守体制

通常の使用で発生した故障の修理及び定期的に保守点検を実施できる体制であること。

② 支援体制

年間を通じて 24 時間連絡ができる体制であり、障害時において復旧のため通報を受けてから、24 時間以内に現場にて対応ができる体制であること。

③ 保証期間

納入検査確認後、1年間は通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。

2. 設置条件

(1) 入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を納入することができなくなった場合には、病院側と協議の上後継機種を納入すること。

(2) 取扱説明

- ① 取扱説明に関する教育訓練は、当院が指定する日時、場所で行うこと。
② 操作マニュアルは、日本語版を 2 部とする。

(3) 運搬・設定・調整・既存機器廃棄処分費を含むこと。

3. 納入期限

令和 8 年 3 月 24 日

4. 納入場所

新潟市民病院（新潟市中央区鐘木 463 番地 7）

スチームコンベクションオーブン 要求仕様書

1. 品名・数量

スチームコンベクションオーブン 1台
ラックインカート 1台

2. 参考銘柄

- スチームコンベクションオーブン

メーカー名	商品名	型番等
コメットカトウ	ガススチームコンベクションオーブン	C S X H - G W 2 0 1 - N S

別紙「スチームコンベクションオーブン外観図」による。

- ラックインカート

メーカー名	商品名	型番等
コメットカトウ	ラックインカート	C S X H 2 0 1 用

別紙「スチームコンベクションオーブン用カート」による。


3. 仕様（仕様は最低条件とする）

要求仕様：スチームコンベクションオーブン	
ハードウェア	スチームコンベクションオーブン
外形寸法	W 9 8 0 × D 8 5 5 × H 1 , 8 3 5 (mm) 以内であること
庫内有効寸法	W 4 3 8 × D 6 6 1 × H 1 , 4 0 0 (mm) 以上であること
熱源	ガス方式であること
収容能力	カート1台であること
ガス消費量	4 7 . 4 K w 以内であること
消費電力	1 , 2 0 0 W 以内であること
電源	3相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z であること
定常時最大電流	5 A 以内であること
設定可能範囲	ホット 3 0 ~ 3 0 0 °C であること スチーム 5 0 ~ 1 3 0 °C であること コンビ 3 0 ~ 3 0 0 °C であること
洗浄機能	自動洗浄機能を有し、洗浄用洗剤は固形タブレット型であること リノス剤は、顆粒型（原料は食品添加物）であること
洗浄方式	循環方式であること

芯温センサー	実測値と設定値が常に表示されること
安全装置	立消え安全装置を有すること 庫内以上過熱防止装置を有すること ボイラ空焚き防止機能を有すること 故障時自己診断機能を有すること
重量（乾燥品）	360kg（カートを除く）以内であること

※スチームコンベクションオーブン外観図（参考銘柄）参照

(参考銘柄) 「スチームコンベクションオーブン外観図」

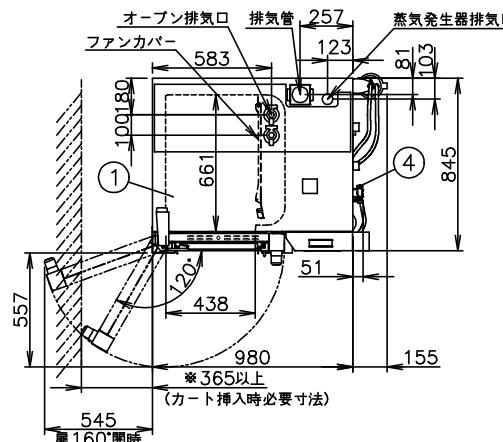

4-#10
P.C.D60
耐震脚形状

ラックサポート総耐荷重	120kg (1段あたり最高45kgまで)
芯温センサ	標準付属: 3点感知
標準付属品	耐熱手袋 (1セット) 液体洗剤 (1)、液体洗剤用スプレー (1) 自動洗浄用洗剤・リンス剤 (1セット) 排水部材セット (1)、カート (1)

No	品名	材質	備考
1	上板	SUS430 t1.0	No.4
2	扉化粧板	SUS304 t1.0	No.4
3	耐震アジャスト	SUS304他	4ヶ所
4	洗净ノズル		
5	コントロール操作及び表示部		
6	コントロール化粧板	SUS304 t1.0	No.4
7	横板	SUS430 t0.8	No.4
8	オーブン庫内壁	SUS304 t1.0	
9	後板	SUS430 t0.8	No.4

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。

2.設置条件について 可燃物からの離隔距離 (cm)

可燃物からの離隔距離 (cm)	上方	側方	前方	後方
場所、電源等は、	フード	20cm以上	15cm以上	

取扱説明書・設置工事説明書に従って正しく行ってください。

3.給水装置性能基準適合品です。

4.カートの最下段は、ホテルパン深さ25mm以下の使用となります。

5.床勾配が1/100以上の場合は、カートキャスター・変更等の特注が必要です。

寸法 (mm)	外形	980(W)	855(D)	1,835(H)
	庫内有効	438(W)	661(D)	1,400(H)
接続	ガス	20A		
	給水	15A	適用水圧 0.2~0.75MPa	
	排水	40A	100°C以上耐熱材	
電気	三相200V	コンセント形状		
		漏電ブレーカーは本機専用で30mA 15A		
		LPガス	47.4kW (3.39kg/h)	
ガス消費量	1.3Aガス	47.4kW (40,800kcal/h)		
	LPGガス			
定格消費電力		1,200W		
定常時最大電流		5A		
温度調節範囲	ホット	30~300°C		
	スチーム	50~130°C		
	コンビ	30~300°C		
安全装置	立消え安全装置 (フレームロッド式)			
	庫内異常過熱防止装置 (液膨張式)			
	ボイラ空焚き防止装置 (バイメタル式)			
構造	庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切りあり			
	庫内加熱方式: 熱交換パイプによる間接加熱方式			
本体重量		360kg		
カート重量		36kg		
ホテルパン収納枚数	1/1GN	20枚 (ピッチ63)		

軟水器付属 (給水接続管、軟水器固定板付)


外部芯温センサ追加(安立製)(ホルダ付、表示計あり)

外部芯温収納BOX付


アローライト付 (運転時: 青、完了時: 赤、異常時: 赤)

プラスチチラー対応 (ラックカート押さえ板下つゆ受け無し)

電源防水ゴムキャップ 引掛けタイプ (WF8430) 付

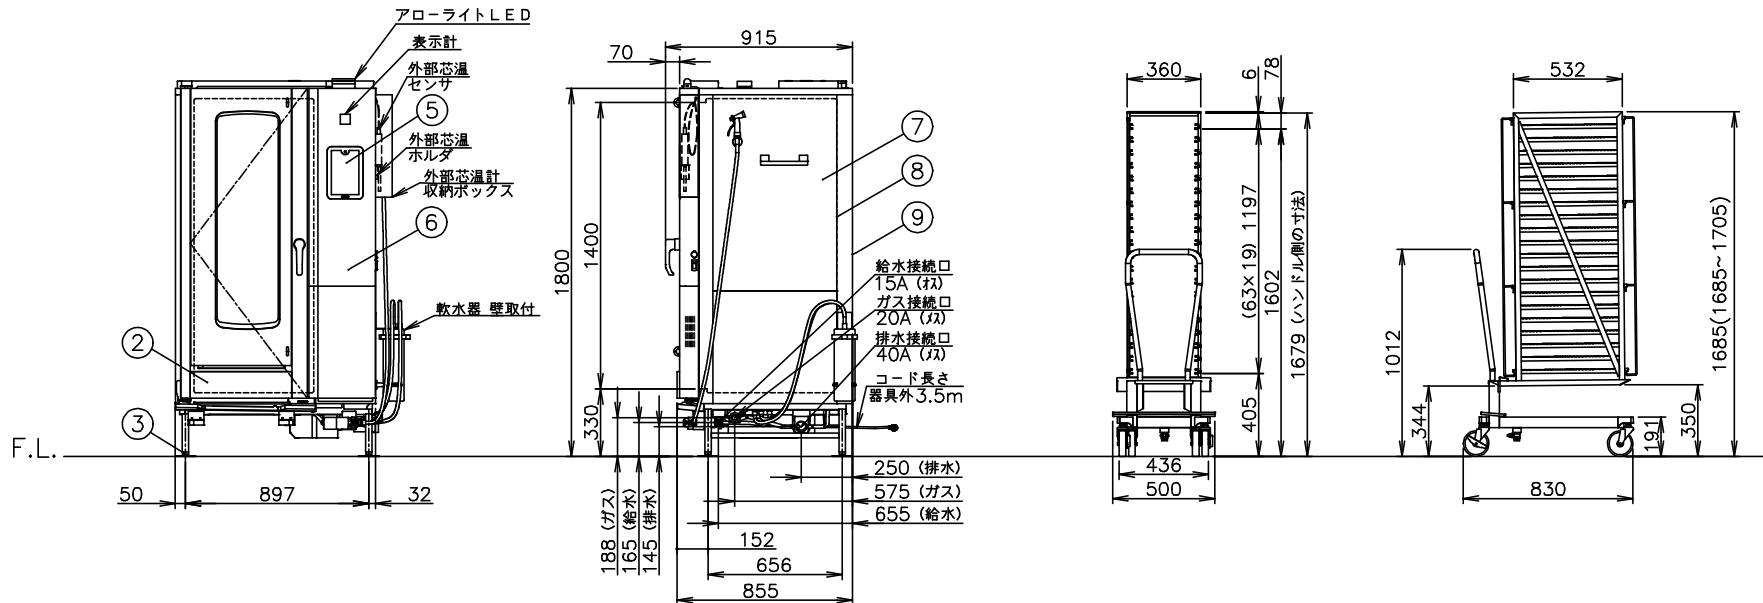

(参考銘柄) 「スチームコンベクションオーブン用カート」


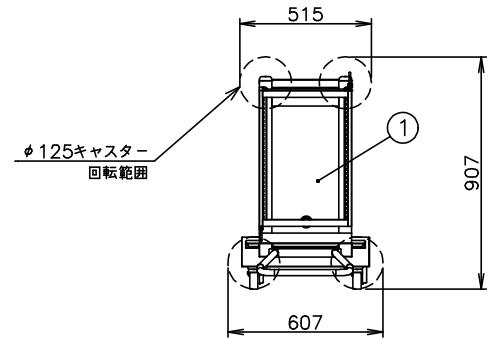


特注：プラスチラー対応
(ラックカート押さえ板下つゆ受け無し)

メーカー名	(株)コメットカトウ
棚段数	20段 ピッチ63mm
ホテルパン収納枚数	1/1GN 20枚
ラックカート総耐荷重	120kg (1段あたり最高45kgまで)
高さ調整幅	1,685~1,705
ラックガイド最上段高さ	1,602mm (カート高さ1,685mm時)
ラックガイド最下段高さ	405mm (カート高さ1,685mm時)

No	品 名	材 質	備 考
1	しる受	SUS304	
2	取 手	SUS304	取り外し式
3	後 輪	ウレタン	自在 ø125ストッパー付
4	前 輪	ウレタン	自在 ø125
5	本 体	SUS304	
6	ストッパー	SUS304	

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。
2.カートの最下段は、ホテルパン深さ25mm以下の使用となります。
3.床勾配が1/100以上の場合は、カートキャスター変更等の特注が必要です。

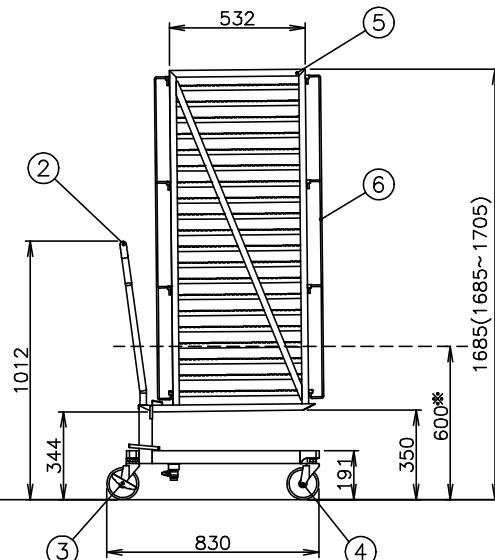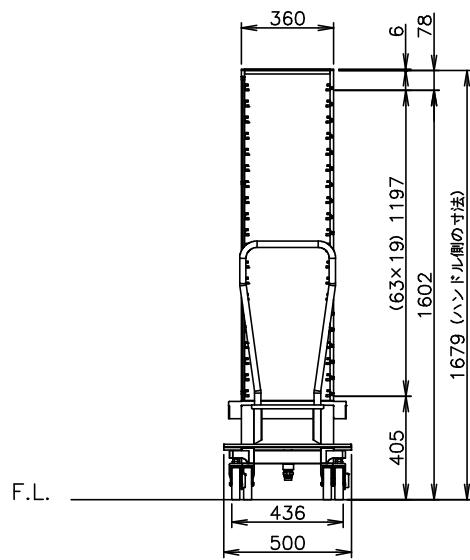

*大量調理施設では、食品を移動する場合
床面から60cm以上で行う事が推奨されています。
大量調理施設衛生管理マニュアルより
(平成9年3月24日衛食第85号別添)
大量調理施設：同一メニューを1回300食以上、
又は1日750食以上を提供する調理施設